FR_P429BE_.qxp 08-11-05 09.01 Sida 1

ENTRETIEN – SÉCURITÉ

Pour garantir le fonctionnement du rollator et la sécurité de son utilisateur, vous devez veiller à ce que les opérations suivantes soient régulièrement faites :

- Nettoyer le rollator à l'aide d'un détergent courant. Essuyer et faire sécher. Nettoyer les roues.
- Contrôler que toutes les vis et autres éléments de réglage sont bien serrés.
- Si le rollator ne fonctionne pas parfaitement, contacter immédiatement le prescripteur.
  Ne jamais utiliser un rollator défectueux. Ne jamais intervenir soi-même sur l'équipement !

ATTENTION ! À n'utiliser que comme soutien à la marche. Poids maximum de l'utilisateur : ***P429/2 - DELTA*** 125 kg. **DOLOMITE** décline toute responsabilité en cas d'interventions effectuées sans son contrôle (adaptations, réparations insuffisantes).

INDICATIONS POUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE:
Une fois le produit définitivement hors d'usage, les pièces et accessoires ainsi que l'emballage doivent être triés correctement. Chaque partie peut être traitée selon le matériau qui la constitue.

Toutes les informations techniques importantes se trouvent sur l'étiquette du ***P429/2 - DELTA***.

1 : Numéro d'article.
2 : Nom du produit.
3 : Numéro de série.
4 : Date de fabrication.
5 : Poids max. de l'utilisateur.
6 : Attention ! Lire le mode d'emploi.
7 : Rollator d'intérieur et d'extérieur.
8 : Largeur maximum du rollator.
9 : Nom du fabricant.

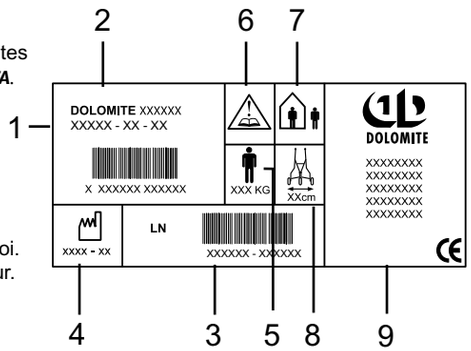

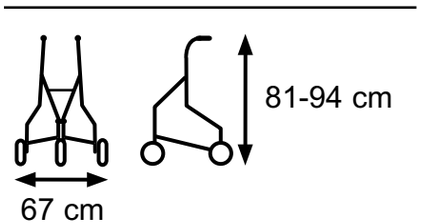

DOLOMITE

Fabricant:
Invacare REA, Växjövägen 303, SE-343 75 Diö, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 98, www.dolomite.biz

Revendeurs:
Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes
TÉL (33) (0)2 47 62 64 66, FAX (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com

1513153 08-09:1

INVACARE

P429/2 - DELTA

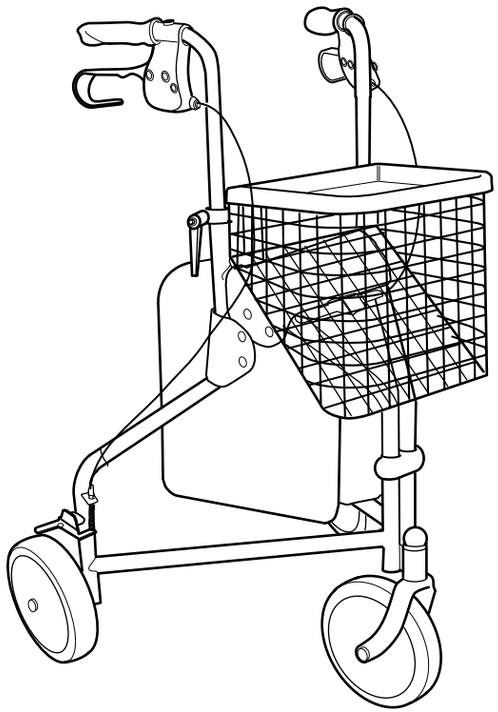

MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement ce mode d'emploi **avant** utilisation.
Le rollator peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

FR_P429BE_.qxp 08-11-05 09.01 Sida 2

SÉCURITÉ

- Le rollator doit toujours être complètement déplié et vissé avant d'être utilisé. ATTENTION ! Utiliser uniquement comme aide à la marche.
- Observer la plus grande prudence lors de la progression sur un terrain en pente.
- Ne pas monter ni descendre des escaliers avec le rollator.
- Ne pas utiliser sur un escalier mécanique.
- Observer la plus grande prudence quand le panier est lourdement chargé.
- Le panier, le sac et la tablette sont seuls destinés à recevoir un chargement. Le poids de charge maximum est de 5 kg dans chacun d'eux.
- Les poignées ne doivent pas être tournées hors de la position indiquée car cela affecterait la stabilité latérale du rollator, voir illust. A.

POIGNÉES

Attention ! Les poignées doivent être orientées de façon à ce que la ligne verticale de la surface de préhension vienne à la hauteur du bord intérieur de la prise du cadre (voir illust. A). Elles ne doivent en aucun cas être orientées autrement car **cela nuirait à la stabilité latérale**.
Pour l'ajustement en hauteur : desserrer les manettes de serrage et régler les poignées à la h auteur souhaitée. ATTENTION ! Les poignées ne doivent jamais être ajustées au-dessus de la ligne de la partie quadrillée du tube.
- Resserrer les manettes de serrage. Ces dernières seront ensuite orientées vers le bas (On libère les manettes de serrage en les tirant vers l'extérieur).
Vérifier que les poignées sont bien réglées à la même hauteur.
Normalement, les poignées sont ajustées à la hauteur des poignets de l'utilisateur.

ACCESSOIRES

B) Montage du panier.
C) Montage de la tablette.
D) Montage du sac.

MONTAGE

Préalablement au montage du rollator, enlever les éventuels bouchons en plastique sur les tubes latéraux. Déplier le rollator dans sa position d'utilisation (voir ci-dessous).

2. Monter la manette de serrage avec vis. La manette de serrage au plateau doit être montée sur le côté externe. S'assurer que le bout de la vis épouse bien le pas de vis de l'attache.
3. Emmancher les tubes des poignées dans les montants latéraux et serrer les manettes. Ces dernières doivent être orientées vers le bas pendant l'utilisation.

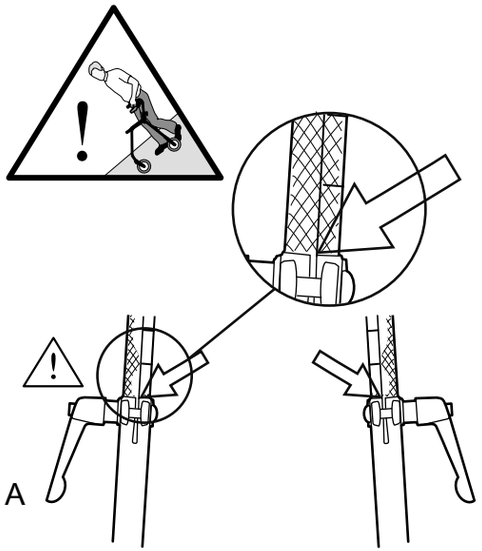

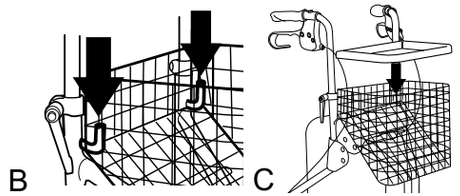



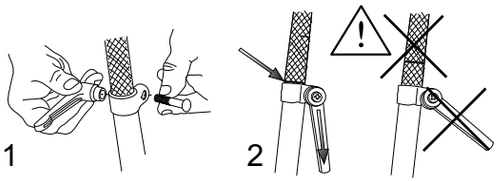

POSITION DE FONCTIONNEMENT

Déplier le rollator en position de fonctionnement. ATTENTION ! Toujours contrôler que le taquet est bien en position de blocage.

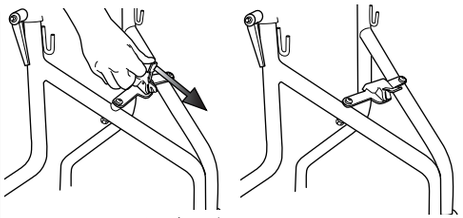

PLIAGE

1. Tirer le taquet vers le haut et l'arrière.
2. Plier le rollator.

ATTENTION de ne pas vous pincer les doigts entre les différentes parties du cadre.

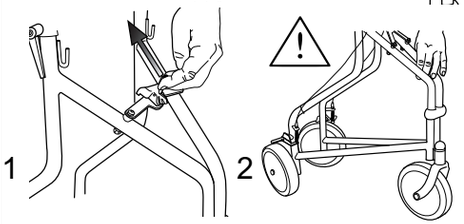

FREINS

Pour ralentir, presser les poignées de frein vers le haut.



FREIN DE STATIONNEMENT

Pour la position de stationnement, appuyer doucement vers le bas sur les poignées de frein. Un "clic" se fait entendre distinctement lorsque la bonne position est atteinte. Il est important que les deux freins soient mis en position de stationnement.
Pour libérer le frein de stationnement, presser les poignées vers le haut.

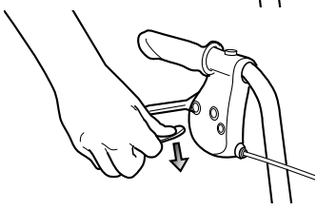

RÉGLAGE DES FREINS

Deux molettes de réglage, l'une sur la poignée de frein et l'autre sur le frein, servent à adapter la tension de freinage aux capacités de l'utilisateur. En dévissant la molette de réglage, on augmente la puissance de freinage et on réduit la force nécessaire pour actionner le frein avec la poignée.

ATTENTION ! Bien resserrer les écrous après le réglage.